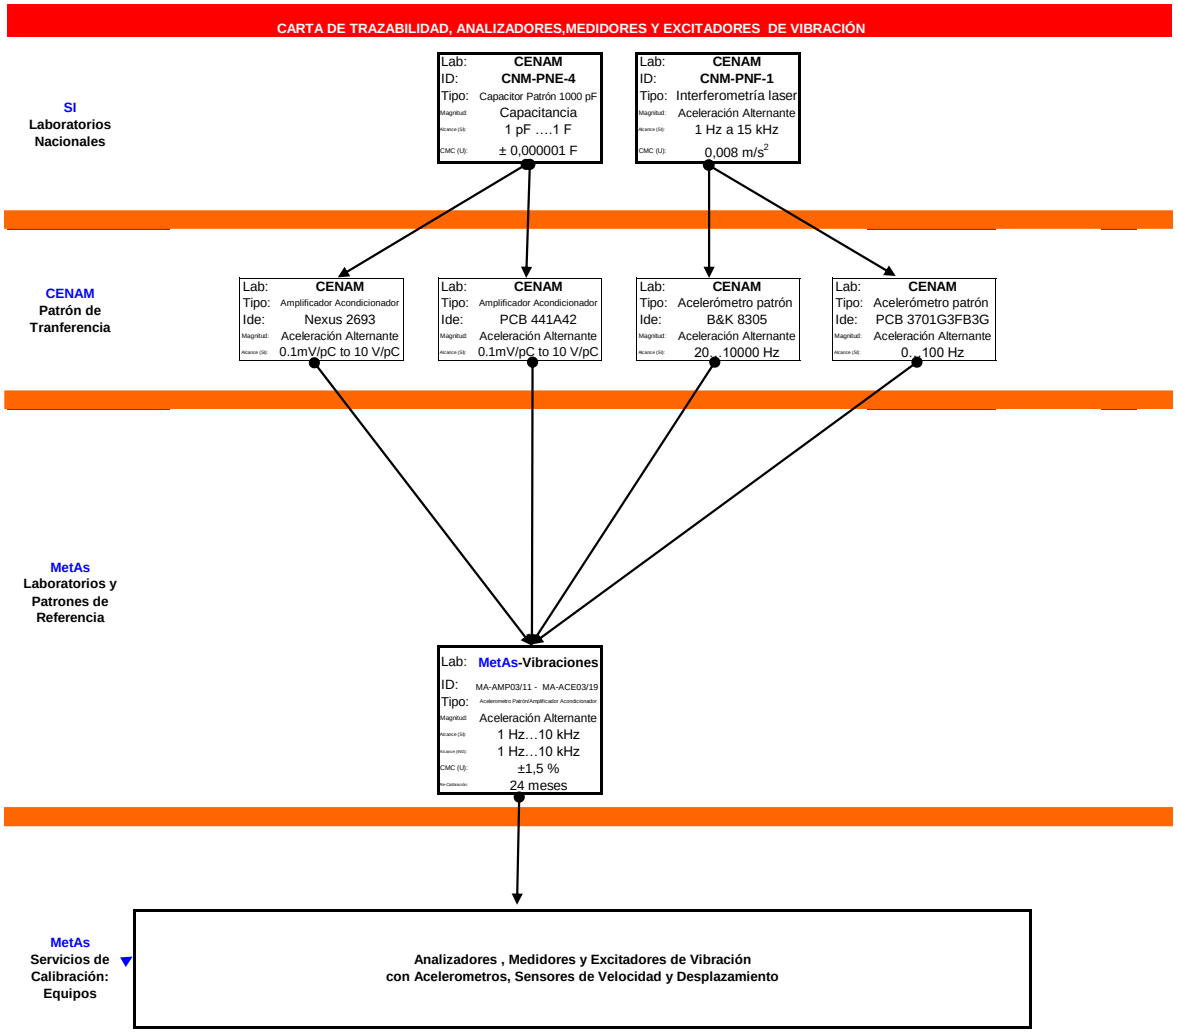
CARTA DE TRAZABILIDAD, ANALIZADORES,MEDIDORES Y EXCITADORES DE VIBRACIÓN
SI
Laboratorios
Nacionales
Lab: CENAM
ID: CNM-PNE-4
Tipo: Capacitor Patrón 1000 pF
Magnitud: Capacitancia
Alcance (Si): 1 pF ….1 F
CMC (U): ± 0,000001 F
Lab: CENAM
ID: CNM-PNF-1
Tipo: Interferometría laser
Magnitud: Aceleración Alternante
Alcance (Si): 1 Hz a 15 kHz
CMC (U): 0,008 m/s2
CENAM
Patrón de
Tranferencia
Lab: CENAM
Tipo: Amplificador Acondicionador
Ide: Nexus 2693
Magnitud: Aceleración Alternante
Alcance (Si): 0.1mV/pC to 10 V/pC
Lab: CENAM
Tipo: Amplificador Acondicionador
Ide: PCB 441A42
Magnitud: Aceleración Alternante
Alcance (Si): 0.1mV/pC to 10 V/pC
Lab: CENAM
Tipo: Acelerómetro patrón
Ide: B&K 8305
Magnitud: Aceleración Alternante
Alcance (Si): 20…10000 Hz
Lab: CENAM
Tipo: Acelerómetro patrón
Ide: PCB 3701G3FB3G
Magnitud: Aceleración Alternante
Alcance (Si): 0…100 Hz
MetAs
Laboratorios y
Patrones de
Referencia
Lab: MetAs-Vibraciones
ID: MA-AMP03/11 - MA-ACE03/19
Tipo: Acelerometro Patrón/Amplificador Acondicionador
Magnitud: Aceleración Alternante
Alcance (Si): 1 Hz…10 kHz
Alcance (MO): 1 Hz…10 kHz
CMC (U): ±1,5 %
Re-Calibración: 24 meses
MetAs
Servicios de
Calibración:
Equipos
Analizadores , Medidores y Excitadores de Vibración
con Acelerometros, Sensores de Velocidad y Desplazamiento